


DLP[®] Link[™] 3D Glasses

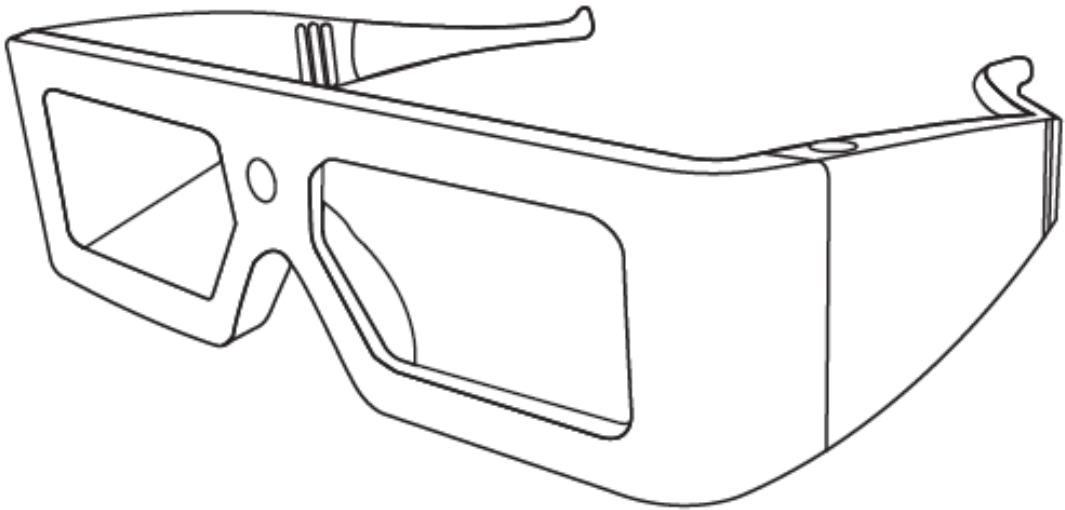


User Manual
Manuel d'Utilisateur
Benutzerhandbuch
Manual de Usuario
使用手冊
用戶手冊
ユーザーマニュアル
사용 설명서

3D Glasses User's Guide

System Requirements

3D Glasses are designed to be emitter free and work with 3D enabled DLP® projectors and televisions. Turn on the 3D mode on the display in DLP®-Link™ mode when using 3D content. Do note, some displays will automatically switch to 3D mode when 3D content is played.

3D Glasses

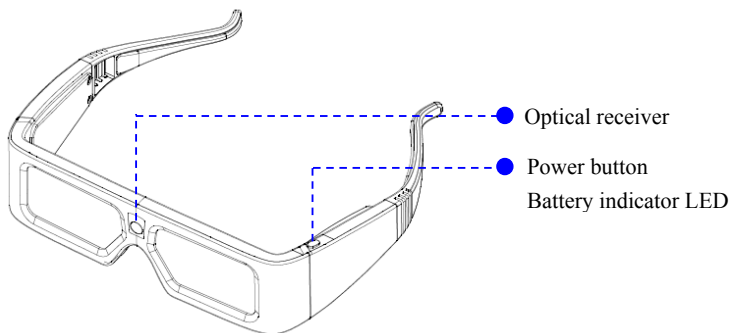

Operation Guide

1. To turn on 3D Glasses
Press the power button and the LED will flash one time indicating the glasses are ready to use 3D mode.
2. Verify that 3D content is being sent to the projector and signal is compatible with projector specifications
3. Turn on 3D mode in projector on-screen menu. 3D mode is located in Display settings section.
4. Turn on 3D glasses and verify image appears in 3D and there is no eye-strain.
5. If the image does not appear in 3D repeat previous steps (1) – (4)
6. If the projected image still does not appear to be 3D change the 3D sync invert setting. The 3D invert setting is located in the Display section of the projector menu.
7. For additional set-up information refer to the projector user's manual.
8. To turn off 3D Glasses
Press the power button and hold until the LED switches off

Battery Indicator


The 3D Glasses include two coin type CR2032 standard manganese lithium batteries. If battery life is close to the end, the battery indicator LED will flash 4 times consecutively every 1 minute. This behavior will repeat until the battery life is ended. When you turn on 3D Glasses under low battery level the LED will be dimly lit for 5 seconds. After that the 3D Glasses will be shut off automatically.

Battery Replacement

- Battery Installation


When you need to replace the batteries, loosen the screw, remove the old batteries and insert two new 3V coin type CR2032 non-chargeable batteries. The anode (+) of batteries must face outside.

Step 1 Loosen the screw

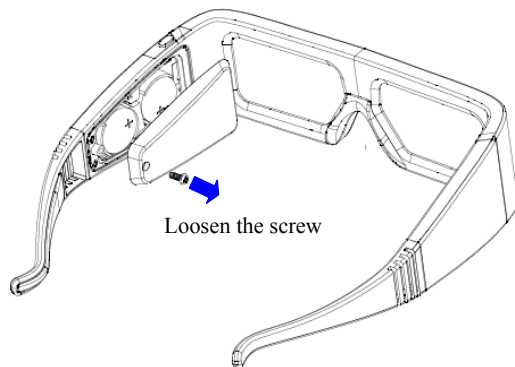


Step 2 Battery Removal

Gently pull back the metal clips to release the batteries..

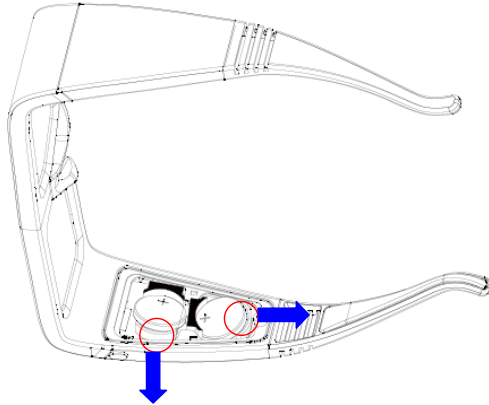


Step 3 Insert new batteries

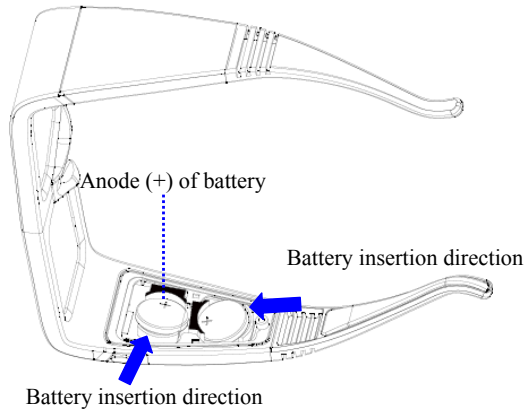

Nosepiece Change

3D Glasses come with three interchangeable nosepieces to provide a comfortable fit. You should pull out the current nosepiece and insert the one that fits you best.

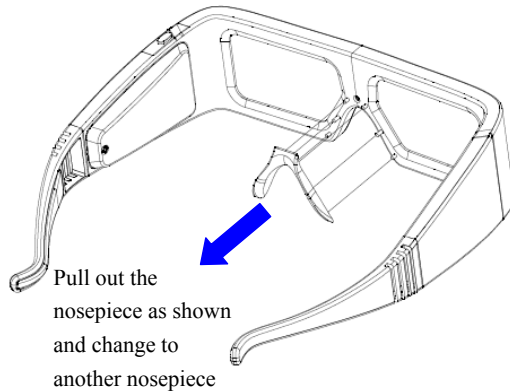

Items in the Box

The following parts are included in the carton.

- (1) 3D Glasses



- (3) interchangeable nosepieces
(large, middle, small)



- User's Guide



Compliance & Certification

3D glasses are compliant with the following regulations.

- FCC (Federal Communications Commission)
- CE (European Conformity)

IMPORTANT Safety guidelines:

Do: Take regular breaks when using 3D glasses and if you experience discomfort at any time, discontinue use. We suggest a minimum break of 5 minutes for every hour of use.

Do Not: Use 3D glasses for any other purpose than outlined in this manual.

Use 3D glasses for extended periods of time.

Use 3D glasses before consulting a medical professional, if your family has a history of Epilepsy or Photosensitive Seizures.

Use the glasses as sunglasses.

If any negative symptoms occur, do not engage in any potentially hazardous activity (for example driving a vehicle) until your symptoms have completely gone away.

If symptoms persist, discontinue use and do not resume stereoscopic 3D viewing without discussing your symptoms with a physician.

A small percentage of the population may experience epileptic seizures when viewing certain types of TV images or video games that contain flashing patterns of light.

The following people should consult a physician before viewing in stereoscopic 3D:

- Children under 5 years of age.
- Anyone with a history of epilepsy, or who has a family member with a history of epilepsy.
- Anyone who has ever experienced epileptic seizures or sensory disturbances triggered by flashing light effects.

WARNING!

SOME LIGHT PATTERNS MAY INDUCE SEIZURES IN PERSONS WITH NO PRIOR HISTORY OF EPILEPSY, OTHERWISE CONSULT A PHYSICIAN BEFORE USING 3D GLASSES. DISCONTINUE STEREOSCOPIC 3D USE IF YOU EXPERIENCE ANY NEGATIVE SYMPTOMS WHILE VIEWING STEREOSCOPIC 3D IMAGES.


NOTICE LUNETTES 3D

Pré-requis du système

Les lunettes 3D sont conçus pour fonctionner sans émetteur infrarouge, et avec des vidéoprojecteurs DLP® et téléviseurs 3D. Mettre en marche le mode 3D du diffuseur (téléviseur ou vidéoprojecteur) dans le menu DLP®-Link™ lors de la diffusion de contenus 3D.

Note : Certains appareils basculeront de façon automatique en mode 3D lors de la lecture d'un contenu 3D.

Lunettes 3D

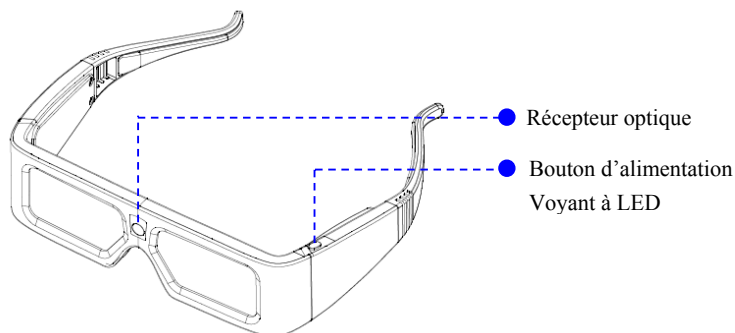

Mise en marche

1. Mise en marche des lunettes

Presser le bouton d'alimentation des lunettes, un clignotement de la LED vous indiquera que les lunettes son prêtes à l'emploi.

2. Vérifier qu'un contenu 3D compatible avec les spécifications du projecteur est envoyé.

3. Mettre en marche le mode 3D dans le menu du projecteur. Le mode 3D se trouve dans la section des réglages d'affichage.

4. Vérifier qu'une image 3D apparaisse bien sans gêne visuelle

5. Si aucune image 3D n'apparaît, recommencer les étapes 1 à 4

6. Si l'image diffusée n'est pas 3D, changer les paramètres de synchronisation 3D. Le réglage 3D sync se trouve dans la section des réglages d'affichage.

7. Pour toutes informations additionnelles, se reporter au manuel utilisateur du projecteur

Extinction des lunettes 3D

Appuyer sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le voyant LED s'éteigne.

INDICATEUR PILES

Les lunettes 3D intègre 2 piles lithium manganèse de type CR2032. Lorsque la puissance des batteries est proche du terme, l'indicateur LED clignotera 4 fois et de façon continue pendant 1 minute. Ce clignotement se répètera de manière continue jusqu'à la fin de vie complète des batteries.


Si les lunettes 3D sont mises en marche avec un niveau de batterie trop faible, le voyant LED s'éclairera de manière très faible et les lunettes s'éteindront automatiquement.

REPLACEMENT DES PILES

- Installation des piles


Lorsque vous souhaitez effectuer le remplacement des piles, dévissez la vis de fixation du cache piles, retirez les piles hors service et remplacez les par des piles neuves de même type. Respecter les polarités comme indiqué sur le schéma.

Etape 1 Retrait de la vis de fixation du cache piles

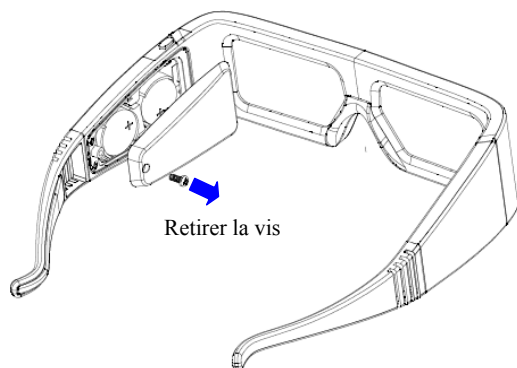


Etape 2 Retrait des piles

Pousser légèrement vers l'arrière la languette métallique maintenant les piles

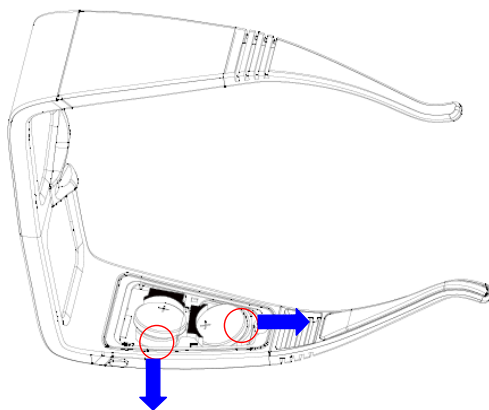


Step 3 Insérer les nouvelles piles

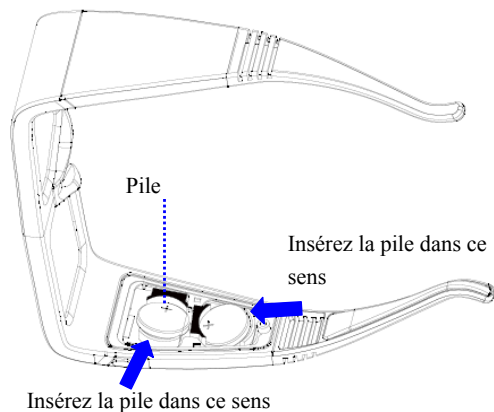

Remplacement de la pièce se situant autour du nez

Les lunettes 3D sont fournies avec des pièces interchangeable au niveau du nez afin de vous offrir le meilleur confort possible. Essayez celle qui vous convient le mieux et fixez-la aux lunettes.

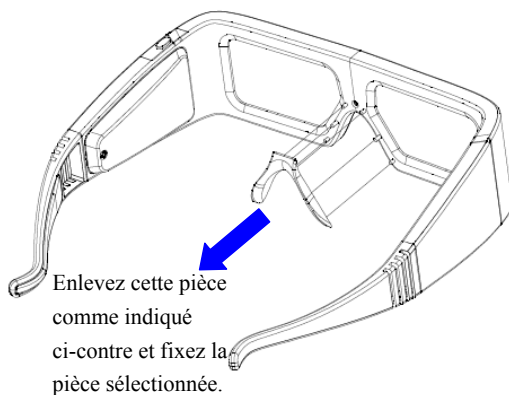

Pièces contenu à l'intérieur de la boîte

Les pièces suivantes sont incluses dans la boîte

- (1) Lunettes 3D



- (3) Quatre pièces pour le nez interchangeables
(grand, moyen, petit et très petit)



Manuel utilisateur



Conformité & Régulation

Les lunettes 3D sont conformes aux réglementations suivantes :

- FCC (Federal Communications Commission)
- CE (European Conformity)

Données importantes à respecter pour votre sécurité :

A faire : Faites des pauses de façon régulière, au moins 5 minutes par heure. Si le moindre inconfort survient avant, n'hésitez pas à faire une pause avant.

A ne pas faire :

- **N'utilisez pas les lunettes 3D pour une utilisation autre que celle indiquée au sein de cette notice.**
- **Utilisez les lunettes 3D pour une utilisation longue durée.**
- **Consultez votre médecin avant toute utilisation de lunettes 3D si vous avez des antécédents d'épilepsie.**
- **Utilisez les lunettes 3D comme des lunettes de soleil.**

Si vous constatez le moindre symptôme négatif, ne vous lancez pas dans la moindre activité au sein de laquelle votre attention est requise (conduire par exemple) jusqu'à la disparition de ces symptômes.

Un pourcentage minime de la population peut connaître des crises d'épilepsie en regardant des images 3D.

Les personnes suivant doivent consulter un spécialiste avant de visionner des images 3D :

- **Enfants de moins de 5 ans**
- **Quiconque ayant des précédents en terme d'épilepsie**
- **Quiconque ayant ressenti une sensation de mal-être générée par des effets de lumière.**

ATTENTION !

Certains effets de lumière peuvent provoquer des attaques même chez des personnes n'ayant jamais eu de crise d'épilepsie. N'hésitez pas à consulter un médecin avant toute visualisation 3D.


Continuer à visualiser un contenu 3D alors que l'on ressent un malaise, même léger, n'est pas conseillé.

Benutzerhandbuch 3D Brille

System Voraussetzungen

Die 3D Brillen sind für Betrieb ohne Sender entwickelt und arbeiten zusammen mit 3D DLP® ausgestatteten Projektoren und Fernsehern. Schalten sie ihr Display in den DLP®-Link™ Modus, wenn sie sich 3D Bildinhalte anschauen möchten. Beachten sie dabei bitte, dass einige Displays automatisch in den 3D Modus umschalten.

3D Brille

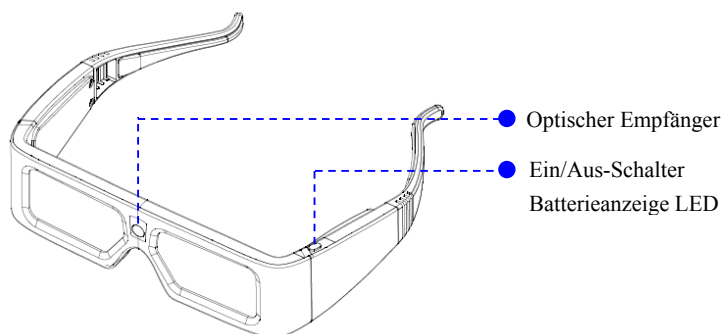

Bedienungsanleitung

1. Drücken sie den Ein/Aus-Schalter, um die 3D Brille einzuschalten. Die LED wird einmal blinken um anzuzeigen, dass die Brille einsatzbereit ist. Die 3D Brille ist nun im 3D Modus.
2. Vergewissern sie sich, dass der Projektor mit 3D Bildmaterial gespeist wird und das Signal mit den Projektor Spezifikationen kompatibel ist.
3. Schalten sie den Projektor über das On-Screen Menü in den 3D Modus. Den 3D Mode finden sie unter Display Einstellungen.
4. Überprüfen sie nach dem Einschalten der 3D Brille, ob das Bild in 3D erscheint und keine Belastungen der Augen auftreten.
5. Wenn das Bild nicht in 3D erscheint wiederholen sie bitte Schritt 1-4.
6. Sollte das projizierte Bild immer noch nicht in 3D erscheinen, so ändern sie die 3D Sync Invert Einstellung. Sie finden die 3D Sync Invert Einstellung im Projektor Menü unter Display Einstellungen.
7. Weitere Einstellungsinformationen finden sie im Benutzerhandbuch ihres Projektors.

8. Zum Ausschalten der 3D Brille drücken sie bitte den Ein/Aus-Schalter und halten ihn so lange gedrückt, bis die LED erlischt.

Batterieanzeige


In ihre neu erworbene 3D Brille sind bereits zwei nicht aufladbare Lithium Knopfzellen vom Typ CR2032 eingesetzt. Wenn die Batterien fast leer sind, blinkt die Batterieanzeige LED 4 mal hintereinander. Dieser Vorgang wiederholt sich jede Minute bis die Batterien leer sind. Wenn die Brille mit fast leeren Batterien eingeschaltet wird, wird die LED für 5 Sekunden schwach leuchten, danach schaltet sich die 3D Brille automatisch aus.

Batteriewechsel

- Einsetzen der Batterien


Lösen sie zum Wechseln der Batterien die unten abgebildete Schraube, entfernen sie die alten Batterien und setzen sie zwei neue Lithium Knopfzellen vom Typ CR2032 ein. Der Pluspol der Batterien muss dabei zur Brillenmitte zeigen.

Schritt 1: Lösen der Schraube

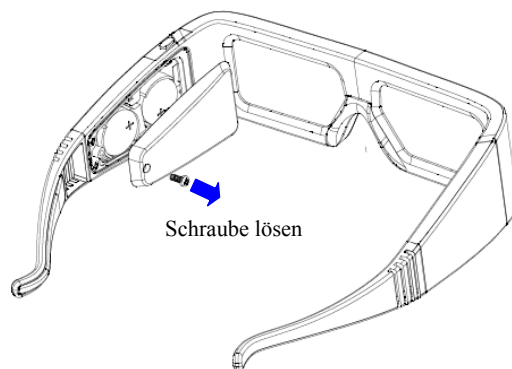


Step 2 Entfernen der Batterien

Heben sie vorsichtig die Metallclips an und entfernen sie die alten Batterien.

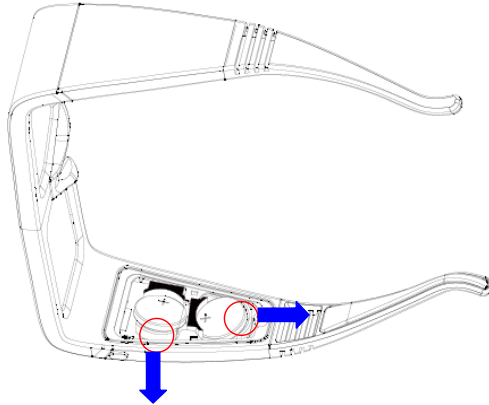


Step 3 Einsetzen der neuen Batterien

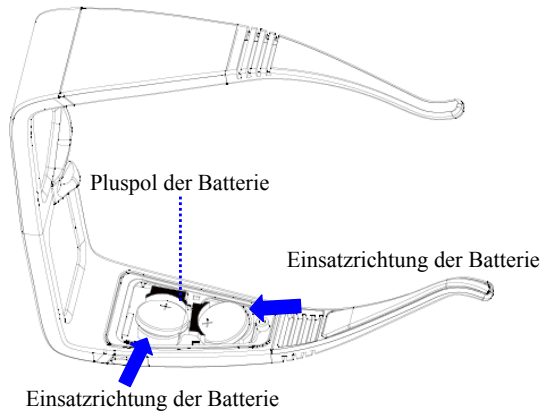

Wechsel der Nasenstützen

Die 3D Brille wird mit drei auswechselbaren Nasenstützen für einen komfortablen Sitz der Brille ausgeliefert. Zum Wechsel ziehen sie die momentan eingesetzte Nasenstütze in horizontaler Richtung wie abgebildet ab und ersetzen sie durch die Nasenstütze, die ihnen am besten passt.

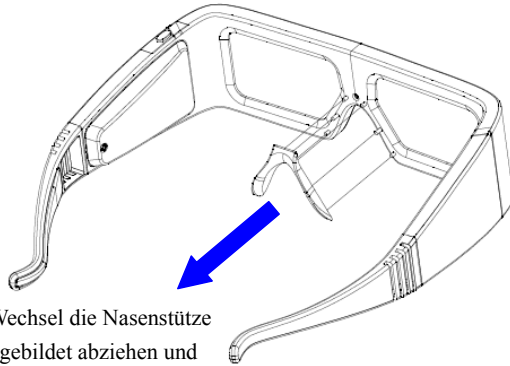

Zum Wechsel die Nasenstütze wie abgebildet abziehen und durch eine andere ersetzen.

Packungsinhalt

Die folgenden Teile finden sie in der Verpackung:

- Eine 3D Brille



- Vier auswechselbare Nasenstützen
(groß, mittel, kleins sehr klein)



- Benutzerhandbuch



Regelkonformität & Zertifizierungen

Die 3D Brille entspricht den folgenden Bestimmungen:

- FCC (Federal Communications Commission)
- CE (European Conformity)

WICHTIG! Sicherheitshinweise:

Was sie tun sollten:

Legen sie regelmäßig Pausen ein wenn sie die 3D Brille benutzen, wir empfehlen Pausen von mindestens 5 Minuten nach jeder Stunde Benutzung. Sollten Beschwerden auftreten, so brechen sie bitte die Benutzung der 3D Brille ab.

Was sie nicht tun sollten:

Benutzen sie 3D Brille nur für die im Handbuch keine anderen als die beschriebenen Zwecke.

Benutzen sie die 3D Brille nicht über längere Zeiträume.

Wenn in ihrer Familie Epilepsie oder fotosensitive Krämpfe aufgetreten sind, so lassen sie sich bitte professionell medizinisch beraten, bevor sie die 3D Brille benutzen.

Benutzen sie die 3D Brille nicht als Sonnenbrille.

Was sie nicht tun sollten wenn Beschwerden auftreten:

Vermeiden sie risikoreiche Situationen (zum Beispiel Autofahren) bis die Beschwerden vorüber sind.

Wenn Beschwerden weiterhin bestehen beenden sie die Benutzung und setzen sie sie nicht weiter fort ohne ihre Symptome zuvor mit einem Arzt besprochen zu haben.

Bei einem sehr geringen Anteil der Benutzer können epileptische Krämpfe auftreten, wenn bestimmte Arten von Fernsehbildern oder Videospiele blitzende Lichtmuster enthalten.

Folgende Personen sollten einen Arzt aufsuchen bevor sie sich stereoskopische 3D Bilder anschauen:

- Kinder im Alter unter 5 Jahren

- Jeder, in dessen Familie ein Fall von Epilepsie aufgetreten ist
- Jeder, der schon einmal epileptische Anfälle hatte oder der empfindlich mit Störungen auf blitzende Lichteffekte reagiert

WARNUNG!


EINIGE LICHTEFFEKTE KÖNNEN KRÄMPFE AUCH BEI PERSONEN VERURSACHEN, DIE BISHER KEINEN EPILEPTISCHE VORGESCHICHTE HABEN, BEI BEDENKEN KONSULTIEREN SIE BITTE EINEN ARZT BEVOR SIE DIE 3D BRILLE BENUTZEN. UNTERBRECHEN SIE DIE STEREOSKOPISCHE 3D NUTZUNG, SOBALD SIE NEGATIVE SYMPTOME BEIM BETRACHTEN DER STEREOSKOPISCHEN 3D BILDER BEMERKEN.

Guía de usuario Gafas 3D

Requerimientos del sistema

Las Gafas 3D están diseñadas para ser emisores libres y trabajar con proyectores DLP® y televisiones que permiten 3D. Seleccione el modo 3D del display en el modo DLP®-Link™ cuando esté usando contenidos 3D. Observen, algunas exhibiciones cambiarán automáticamente al modo 3D cuando el contenido 3D es iniciado.

Gafas 3D

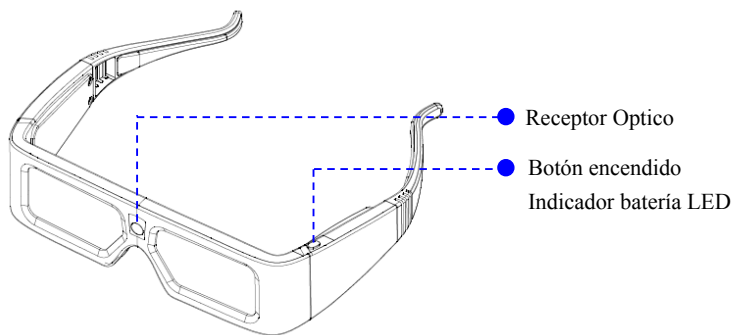

Guía de funcionamiento

1. Para activar las Gafas 3D

Presione el botón de encendido y el LED parpadeará una vez indicando que las gafas están preparadas para usar el modo 3D.

2. Verifique que el contenido 3D está siendo enviado a el proyector y que la señal es compatible con las especificaciones del proyector.
3. Seleccione el modo 3D en la pantalla de menu del proyector. El modo 3D está localizado en la sección de ajustes del Display.
4. Active las gafas 3D y verifique que la imagen aparece en 3D y que no hay distorsión visual.
5. Si la imagen no aparece en 3D repita los pasos previos (1) – (4)
6. Si la imagen proyectada aun no aparece en 3D cambie la sincronización 3D invirtiendo el ajuste el ajuste invertido de sincronización 3D. El ajuste invertido 3D está localizado en la sección del menú del proyector en el Display.
7. Para información adicional de montaje acuda al manual de usuario del proyector.
8. Para desactivar las Gafas 3D.

Presione el botón de encendido y espere hasta que el LED se apague.

Indicador de batería


Las Gafas 3D incluyen dos pilas tipo CR2032 estándar de litio y manganeso. Si la duración de las pilas está próxima a su fin, el indicador de batería LED parpadeará 4 veces consecutivamente cada 1 minuto. Este comportamiento se repetirá hasta que la vida de las pilas se acabe. Cuando active las Gafas 3D con bajo nivel de batería el LED estará vagamente encendido durante 5 segundos. Después de esto las Gafas 3D se apagarán automáticamente.

Recambio de la batería

- Instalación de la batería


Cuando necesites cambiar las pilas, aflojen el tornillo, quiten las viejas pilas e inserten las dos nuevas 3V pilas tipo CR2032 no recargables. El ánodo (+) de las pilas debe estar hacia fuera.

Paso 1 Aflojen el tornillo

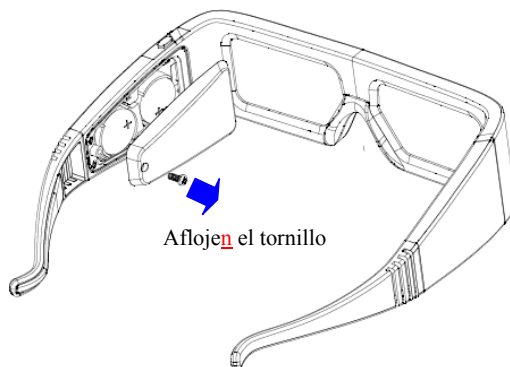


Paso 2 Retire las pilas

Tiren suavemente de los clips de metal para sacar las pilas..

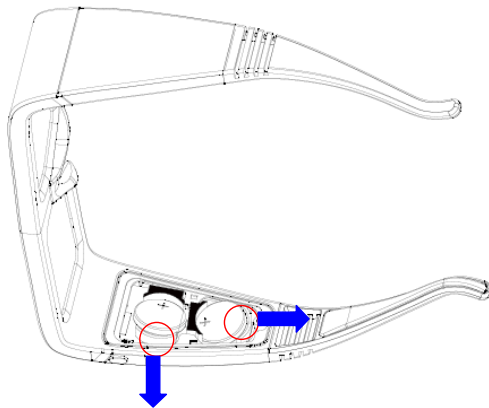


Paso 3 Inserte las nuevas pilas

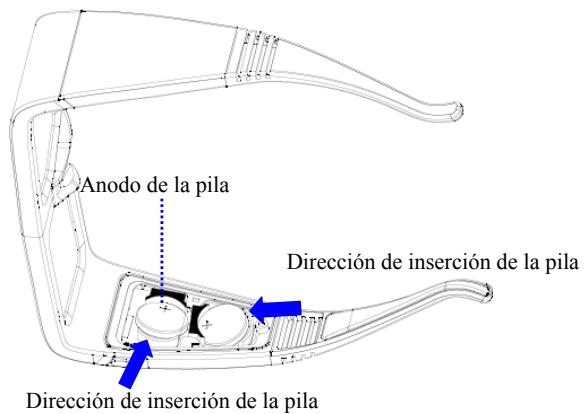

Cambio de la pieza de la nariz

Las Gafas 3D vienen con tres viseras de la nariz intercambiables para proporcionar un ajuste cómodo. Usted debería sacar la pieza actual e insertar una que se ajuste mejor a usted.

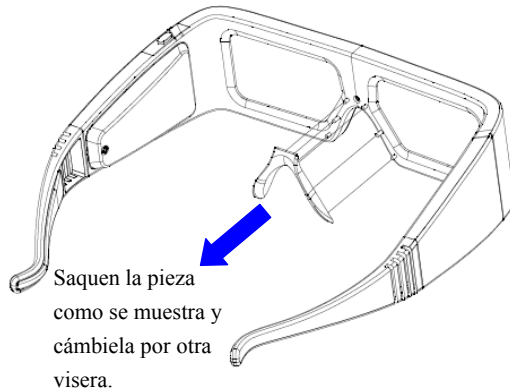

Contenido de la caja

Las siguientes partes están incluidas en la caja.

- (1) Gafas 3D



- (3) Piezas para la nariz intercambiables (grande, mediana, pequeña)



- Guía de usuario



Conformidad y certificación

Las gafas 3D están conformes con las siguientes regulaciones.

- FCC (Federal Communications Commission)
- CE (European Conformity)

Pautas de seguridad IMPORTANTE:

Hacer: Tomen las paradas regulares cuando usen las gafas 3D y si manifiestan malestar en cualquier momento, interrumpan el uso.. Sugerimos una parada mínima de 5 minutos cada hora de uso.

No hacer: Usar las gafas 3D para cualquier otro propósito que aparezca en este manual.

Usar las gafas 3D durante largos periodos de tiempo.

Usar las gafas 3D antes consultando a un profesional medico, si su familia tiene un historial de Epilepsia o ataques foto sensitivos.

Usar las gafas como gafas de sol.

Si presenta algunos síntomas negativos, no hagan ninguna actividad potencialmente peligrosa (por ejemplo conducir un vehiculo) hasta que los síntomas hayan desaparecido completamente.

Si los síntomas persisten, deje de usarlo y no reanude la vista estereoscópica 3D sin consultar sus síntomas con un médico.

Un pequeño porcentaje de la población experimenta ataques epilépticos cuando ven cierto tipo de imagines de TV o video juegos que contienen flases de luz.

Las siguientes personas deberían consultar a un medico antes de ver en 3D estereoscópica:

- Niños menores de 5 años de edad.
- Alguien con un historial de epilepsia, o quien tenga un miembro de la familia con un historial de epilepsia.
- Alguien que haya experimentado ataques epilépticos o disturbios sensoriales provocados por efectos de flases de luz.

¡ADVERTENCIA!


ALGUNOS PEQUEÑAS MUESTRAS PUEDEN INDUCIR EN ATAQUES EN PERSONAS SIN UN PREVIO HISTORIAL DE EPILEPSIA, SI NO CONSULTAN ANTES DE USAR LAS GAFAS 3D A UN MÉDICO, DEJE DE UTILIZAR EL 3D ESTEREOSCÓPICO SI SU EXPERIENCIA TIENE ALGUN SINTOMA NEGATIVO MIENTRAS VE IMÁGENES 3D ESTEREOSCÓPICAS.

3D 眼鏡使用手冊

系統需求

3D眼鏡採無發射器的設計，可搭配具有3D功能的DLP®投影機與電視使用。觀看3D數位內容時，請開啓DLP®-Link™ 模式內的3D顯示。請務必注意，播放3D數位內容時，部分顯示器將會自動切換至3D模式。

3D 眼鏡

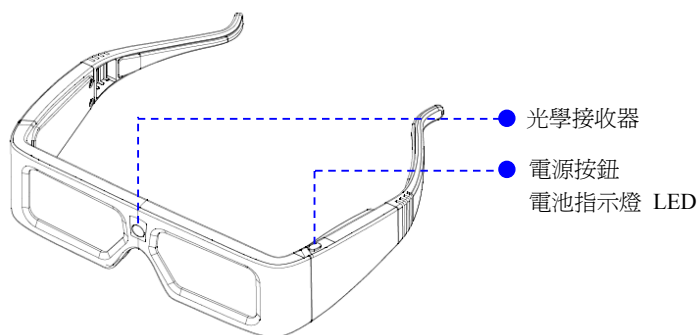

操作指南

1. 開啓 3D 眼鏡。

按下電源按鈕後，LED 將閃爍一下，表示已可準備使用眼鏡的 3D 模式。

2. 檢查 3D 數位內容是否正傳送至投影機，且訊號相容於投影機規格。
3. 開啓投影機螢幕上選單內的 3D 模式，3D 模式位於顯示設定內。
4. 開啓 3D 眼鏡並檢查是否出現 3D 影像，且眼睛不會感到疲勞。
5. 若未出現 3D 影像，請重複步驟 (1) – (4)。
6. 若仍未投射出 3D 影像，請變更 3D 同步反轉設定。3D 反轉設定位於投影機選單的顯示部分內。
7. 如需其他設定資訊，請參閱投影機的使用手冊。
8. 關閉 3D 眼鏡。
按住電源按鈕，直至 LED 熄滅。

電池指示燈


3D 眼鏡內含 2 顆標準的 CR2032 鈕釦式錳鋰電池。電池使用壽命快結束時，電池指示燈將每隔 1 分鐘連續閃 4 次，此項動作將重複進行至電池壽命結束為止。若在電量不足時開啓 3D 眼鏡，LED 將會微亮 5 秒鐘，之後 3D 眼鏡將會自動關閉。

更換電池

- 安裝電池


需要更換電池時，請鬆開螺絲、取出舊電池，然後將全新的兩顆一次性 3V CR2032 鈕釦式電池裝入。電池的正極(+)必須朝外。

步驟 1 鬆開螺絲

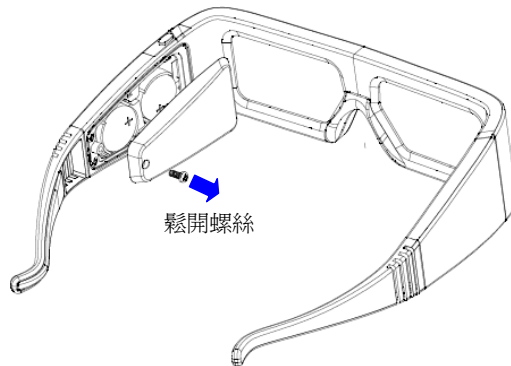


步驟 2 取出電池

請向後輕拉金屬片，來解開並取出電池。

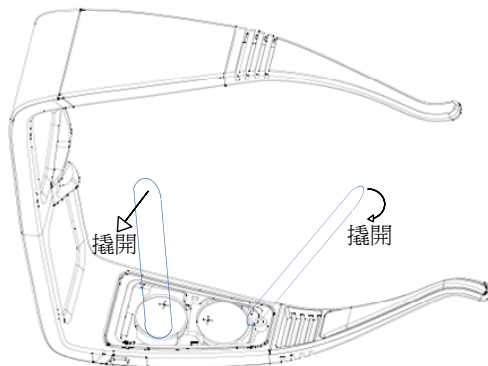


步驟 3 裝入新電池

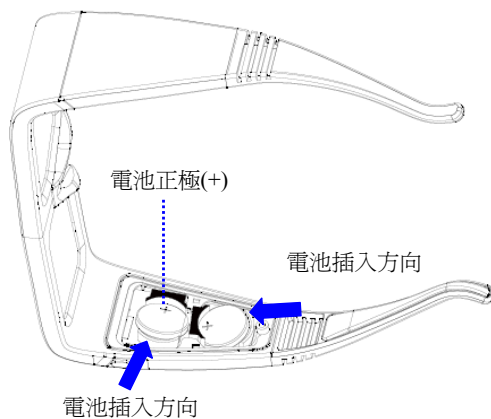

更換鼻墊

3D眼鏡附有3組可互換使用的鼻墊，能提供最舒適的配戴感受。您應取下目前的鼻墊，然後裝上最適合您的鼻墊。

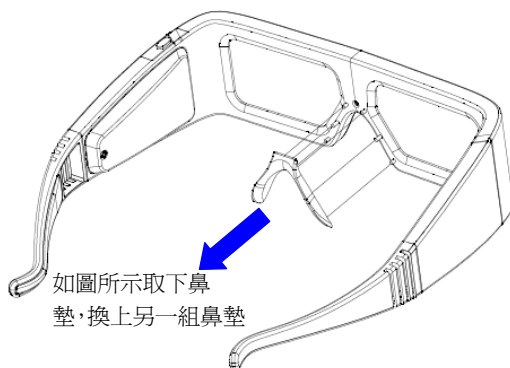

箱內物品

以下為紙箱內的零件。

- (1) 3D 眼鏡



- (3) 可互換使用的鼻墊
(大、中、小)



- 使用手冊



符合性及認證

3D 眼鏡符合以下法規。

- FCC (聯邦通訊委員會)
- CE (符合歐規)

重要安全準則：

需遵照： 使用 3D 眼鏡時定時稍作休息，並在感到不適時停止使用。我們建議您使用一小時後至少休息 5 分鐘。

請勿： 將 3D 眼鏡作為本手冊所述以外之用途使用。

長時間使用 3D 眼鏡。

若您的家族有癲癇或光敏感性癲癇的病史，請在使用 3D 眼鏡前向專業醫療人員諮詢。

將 3D 眼鏡作為太陽眼鏡使用。

若出現任何負面症狀，請勿進行任何可能的有害活動（例如開車），直至您的症狀完全消失為止。

若症狀無法消除，請停止使用，且必須與醫師討論您的症狀後，才可繼續觀看立體 3D 影像。

少部分人可能在觀看包含閃光的特定電視影像或電視遊戲時，出現癲癇發作的症狀。

以下族群應在觀看立體 3D 影像時向醫師諮詢：

- 5 歲以下兒童。
- 任何有癲癇病史，或家族成員有癲癇病史的人。
- 曾有癲癇發作或因閃光特效而誘發感覺障礙的人。

警告！


某些光圖型可能誘發之前無癲癇病史的人出現癲癇發作的症狀，請在使用 3D 眼鏡之前向醫師諮詢。若您在觀看立體 3D 影像時出現任何負面症狀，請立即停止觀看立體 3D 影像。

3D 眼镜用户指南

系统要求

3D 眼镜采用无发射器的设计，可以配合具有3D功能的 DLP® 投影机 and 电视机使用。当观看 3D 内容时，在 DLP®-Link™ 模式下开启 3D 显示模式。请注意，当播放 3D 内容时，部分显示器将会自动切换至3D模式。

3D 眼镜

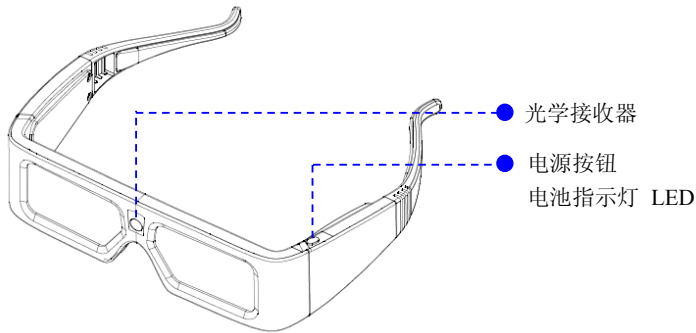

使用指南

1. 开启 3D 眼镜的电源

按下电源按钮后，LED 将闪烁一次，以指明眼镜已准备好使用 3D 模式。

2. 确认 3D 内容是否正传送至投影机，且信号兼容于投影机显示规格。

3. 在投影机的屏幕菜单中开启 3D 模式。3D 模式位于菜单“显示设置”部分。

4. 开启 3D 眼镜，确认图像为 3D 形式并且眼睛舒适。

5. 如果图像不是 3D 形式，请重复前述步骤 (1)–(4)

6. 如果投影图像仍不是 3D 形式，请更改 3D 同步反转设置。3D 反转设置位于投影机菜单的“显示”部分。

7. 如需了解投影机详细设置信息，请参阅投影机的用户手册。

8. 关闭 3D 眼镜的电源

按住电源按钮，直至 LED 熄灭

电池指示灯


3D 眼镜内含两颗标准的 CR2032 纽扣式锂锰电池。如果电池使用寿命快结束时，电池指示灯 LED 将每隔 1 分钟闪烁 4 次。此过程一直持续至电池没电。在电池电量低的情况下开启 3D 眼镜时，LED 将微弱点亮 5 秒。之后，3D 眼镜将自动关闭。

更换电池

- 安装电池


当需要更换电池时，拧松螺丝，取出旧电池，装入两个新的标准的 CR2032 纽扣式锂锰电池。电池正极(+)必须朝外。

步骤 1 拧松螺丝

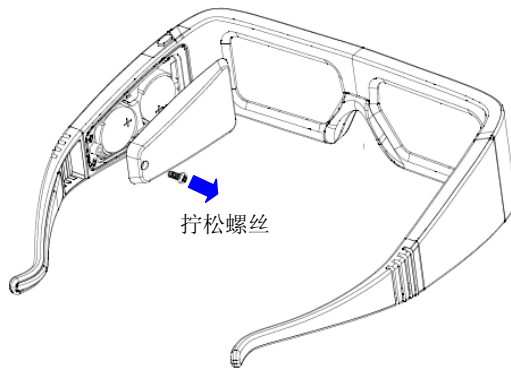


步骤 2 取出电池

轻轻地向后拉金属夹子，松开并取出电池。

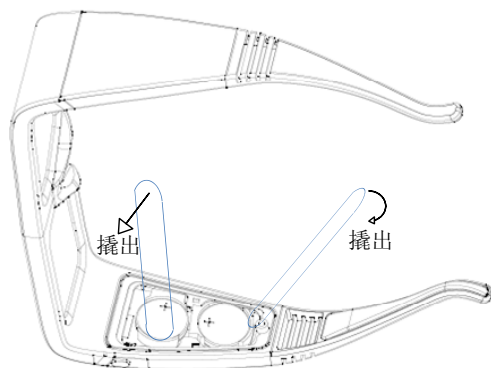


步骤 3 装入新电池

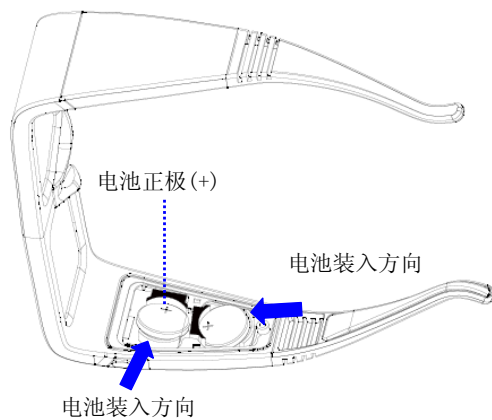

更换鼻梁架

3D 眼镜提供三组可互换的鼻梁架，以便于提供最舒适的佩戴感受。佩戴时若感觉不舒适，建议您抽出目前的鼻梁架，然后插入最适合您的鼻梁架。

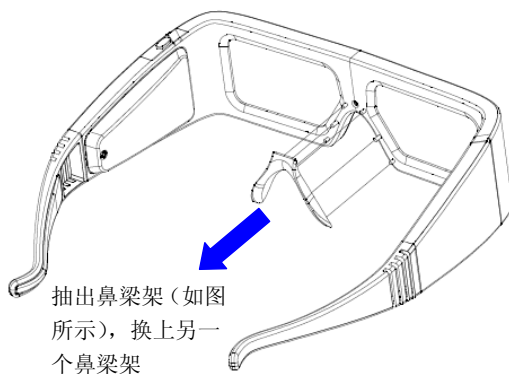

包装盒中的物品

包装盒中包括下列物品。

- (1) 3D 眼镜



- (3) 可互换的鼻梁架
(大、中、小)



- 用户指南



符合性和认证

3D 眼镜如何下列管制认证。

- FCC（联邦通信委员会）
- CE（符合欧规）

重要安全事项：

切记： 当使用 3D 眼镜时应定期休息或当感到不舒适时应随时休息，避免连续使用。我们建议每使用一个小时休息至少 5 分钟。

请勿： 将 3D 眼镜用于本手册中未介绍的任何其他用途。

长时间使用 3D 眼镜。

如果您的家庭有癫痫或光敏感性发作病史，未经咨询专业医师而使用 3D 眼镜。

将此眼镜作为太阳镜使用。

一旦出现任何不良症状，切勿在症状完全消失前从事任何潜在的危险活动（如驾驶机动车）。

如果症状持续存在，应停止使用，切勿在未向医师咨询症状的情况下继续进行 3D 立体观看。

当观看包含闪烁光图案的特定类型的电视图像或视频游戏时，少部分人可能会癫痫发作。

下列人士在观看 3D 立体图像前应咨询医师：

- 5 岁以下的儿童。
- 有癫痫病史，或者其家人有癫痫病史。
- 曾因闪烁光效果而导致癫痫发作或感觉障碍。

警告！


一些光图案可能导致以前没有癫痫病史的人士癫痫发作，因此务必在使用 3D 眼镜前咨询医师。如果在观看 3D 立体图像时出现任何不良症状，应停止观看 3D 立体图像。

3D メガネユーザーズガイド

システム要件

3Dメガネはエミッターを出さず、3D対応のDLP®プロジェクターおよびテレビで使用するよう設計されています。3Dコンテンツを使用するときは、DLP®-Link™モードのディスプレイで3Dモードをオンにします。ディスプレイには、3Dコンテンツが再生されると自動的に3Dモードに切り替わるものもあります。

3D メガネ

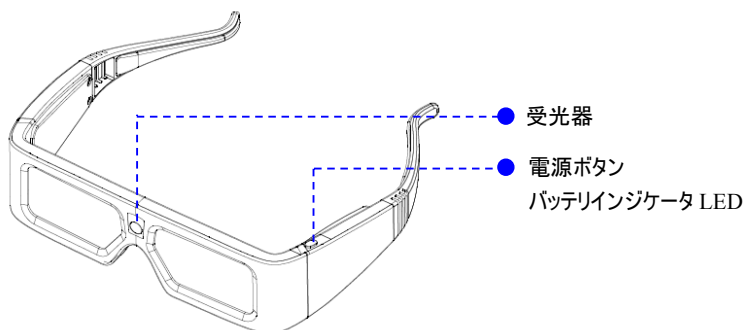

操作ガイド

1. 3Dメガネをオンにするには電源ボタンを押してLEDが1回点滅すると、メガネの3Dモードを使用する準備ができたことを示します。
2. 3Dコンテンツがプロジェクターに送信されており、信号がプロジェクターの仕様に適合していることを確認してください。
3. プロジェクターのオンスクリーンメニューで3Dモードをオンにします。3Dモードはディスプレイ設定セクションにあります。
4. 3Dメガネをオンにしたら、画像が3Dで表示されること、また眼精疲労がないことを確認します。
5. 画像が3Dで表示されない場合、前のステップ(1)–(4)を繰り返してください。
6. それでも、投影された画像が3Dで表示されていないように見えない場合、3D同期反転設定を変更してください。3D反転設定は、プロジェクターメニューのディスプレイセクションにあります。

7. 追加のセットアップ情報については、プロジェクターのユーザーズマニュアルを参照してください。
8. 3D メガネをオフにするには電源ボタンを押し、LED スイッチがオフになるまで押し続けます。

バッテリーインジケータ


3D メガネには、ボタン型の CR2032 標準マンガンリチウムバッテリーが 2 つ入っています。バッテリーがなくなってくると、バッテリーインジケータ LED が 1 分おきに 4 回連続して点滅します。バッテリーが完全になくなるまで、この動作が繰り返されます。バッテリー残量が低下しているときに 3D メガネをオンにすると、LED が 5 秒間かすかに点灯します。その後、3D メガネのスイッチが自動的に切れます。

バッテリーの交換

• バッテリーの取り付け


バッテリーを交換する必要があるら、ねじを緩め、古いバッテリーを取り出して 2 つの新しい 3V ボタン型 CR2032 非充電式バッテリーをセットします。バッテリーのプラス(+)極は外側を向いている必要があります。

ステップ 1 ねじを緩める

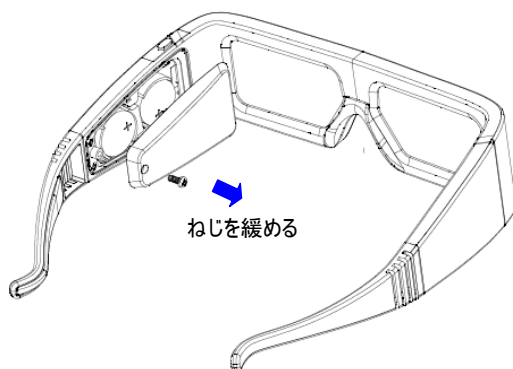


ステップ2 バッテリーの取り出し

金属製クリップをそっと引き戻してバッテリーをはずしたら、取り出します。

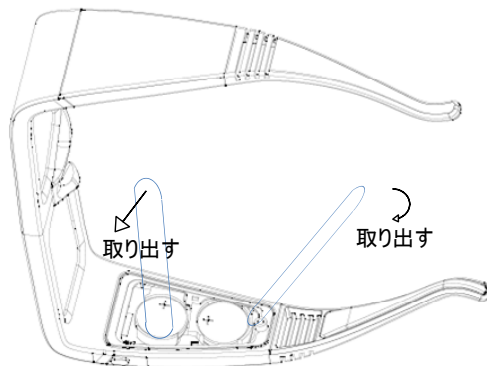


ステップ3 新しいバッテリーをセットする

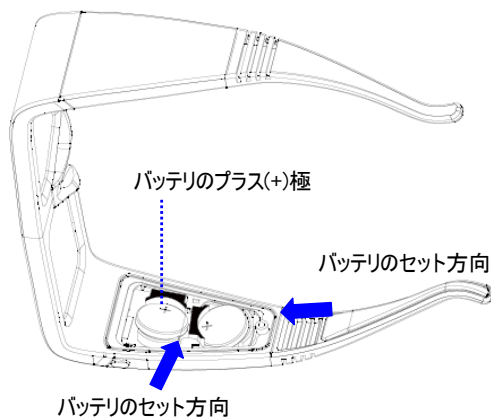

ブリッジの交換

3Dメガネには、鼻にフィットする自然な掛け心地のものを選べるように交換式ブリッジが3つ付属しています。現在のブリッジを引き抜いて、ご自分にもっともよくフィットするものを差し込んでください。

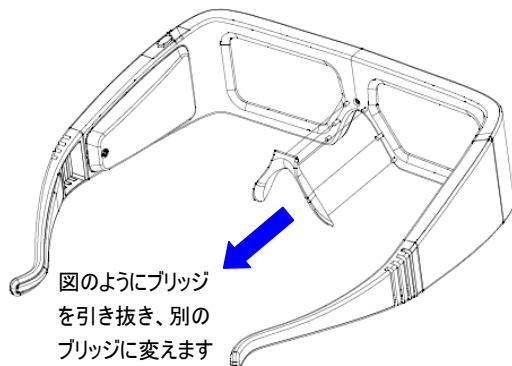

付属品を確かめる

箱の中には、次の部品が入っています。

- (1) 3Dメガネ



- (3) 交換式ブリッジ
(大、中、小)



- ユーザーズガイド



準拠と認証

3Dメガネは次の規制に準拠しています。

- FCC (米・連邦通信委員会)
- CE (欧州適合性)

安全に関する重要なガイドライン:

推奨事項: 3D メガネを使用しているときは定期的に休憩を取り、不快を感じたら直ちに使用を中止してください。少なくとも、1 時間使用したら 5 分間休憩を取るようお勧めします。

禁止事項: 本書で説明した目的以外で 3D メガネを使用すること。

長時間にわたり、3D メガネを使用すること。

家族にてんかんや光過敏性発作の病歴がある場合、医療専門家の診察を受けずに 3D メガネを使用すること。

サングラスとしてメガネを使用すること。

何らかの陰性症状が出た場合、症状が完全に消えるまでは危険性の高い活動(自動車の運転、など)に絶対に携わらないでください。

症状が消えない場合、使用を中止し、医師と症状について話し合うまでは 3D メガネの使用を控えてください。

ごくわずかなパーセンテージですが、点滅する光のパターンを含むある種のテレビ画像やビデオゲームを見ているときにてんかん性発作の症状を起こす人がいます。

次の人々は、3D 画像を見る前に医師に相談する必要があります：

- 5 歳以下お子様。
- てんかんの病歴がある人、または家族にてんかんの病歴がある人。
- 点滅光によりてんかん性発作や知覚障害を引き起こした経験のある人。

警告！


ある光のパターンを見ると、てんかんの病歴のない人でも発作を引き起こすことがあるため、てんかんの病歴がなくても、3D メガネを使用する前に医師の診察を受けてください。3D の立体画像を見ている間に何らかの陰性症状が現れた方は、3D メガネの使用を中止してください。

3D 안경 사용자 설명서

시스템 요구 사항

3D 안경은 이미터가 필요없고 3D 사용 가능 DLP® 프로젝터 및 텔레비전에서 사용할 수 있도록 디자인되었습니다. 3D 콘텐츠 사용 시 DLP®-Link™ 모드의 디스플레이에서 3D 모드를 켜십시오. 일부 디스플레이의 경우, 3D 콘텐츠가 재생되면 3D 모드로 자동 전환됩니다.

3D 안경

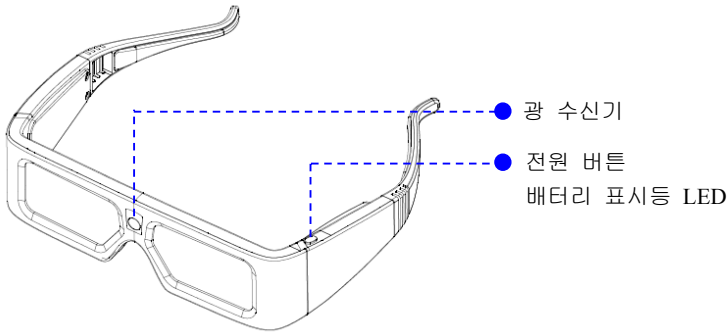

사용 방법

1. 3D 안경 켜기
전원 버튼을 누르면 LED가 한 번 깜박거리면서 안경이 3D 모드를 사용할 준비가 되었다고 알려줍니다.
2. 3D 콘텐츠가 프로젝터로 보내지고 있으며 신호가 프로젝터 사양과 호환되는지 확인합니다.
3. 프로젝터의 화면 메뉴에서 3D 모드를 켭니다. 3D 모드는 디스플레이 설정 섹션에 있습니다.
4. 3D 안경을 켜고 이미지가 3D로 표시되는지, 그리고 눈에 피로를 주는지 확인합니다.
5. 이미지가 3D로 표시되지 않으면, 이전 단계 (1)~(4)를 반복합니다.
6. 투사된 이미지가 계속해서 3D로 표시되지 않으면, 3D 동기화 반전 설정을 변경합니다. 3D 반전 설정은 프로젝터 메뉴의 디스플레이 섹션에 있습니다.

7. 추가적인 설정 정보는 프로젝터의 사용자 설명서를 참조하십시오.
8. 3D 안경을 끕니다.
LED가 꺼질 때까지 전원 버튼을 누르고 있습니다.

배터리 표시등


3D 안경에는 코인 타입의 CR2032 표준 망간 리튬 배터리가 두 개 들어 있습니다. 배터리 수명이 다해 가면 배터리 표시등 LED가 1분에 4번씩 계속 깜박거립니다. 이러한 깜박거림은 배터리 수명이 완전히 끝날 때까지 반복됩니다. 배터리 레벨이 낮은 상태에서 3D 안경을 켜면, LED가 5초 동안 희미하게 켜집니다. 그리고 나서 3D 안경이 자동으로 꺼집니다.

배터리 교체

- 배터리 설치


배터리를 교체해야 하는 경우, 나사를 풀고 다 사용한 배터리를 제거한 다음 3V 짜리 코인 타입의 CR2032 일회용 새 배터리 두 개를 삽입합니다. 배터리의 양극(+)이 바깥쪽을 향해야 합니다.

단계 1 나사를 풉니다.

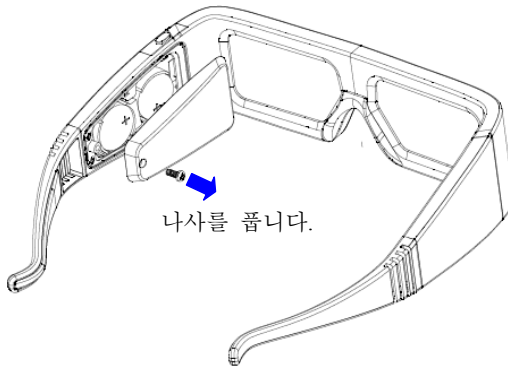


단계 2 배터리 제거

금속 클립을 다시 천천히 당겨 배터리의 잠금을 푼 다음 배터리를 꺼냅니다.

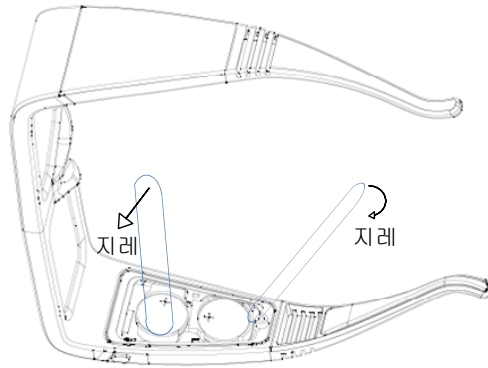


단계 3 새 배터리를 삽입합니다.

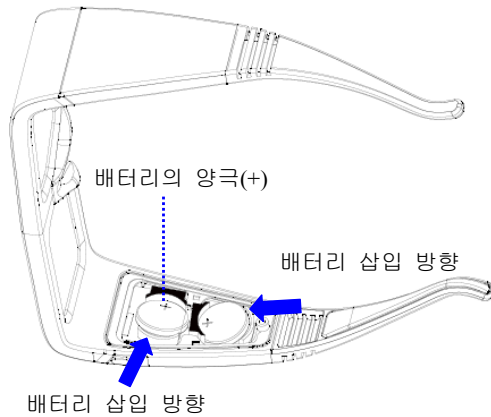

노즈피스 교환

3D 안경은 사용자의 코에 맞게 교환할 수 있는 3개의 노즈피스를 제공합니다. 현재의 노즈피스를 당겨 빼낸 다음 사용자에게 가장 잘 맞는 노즈피스를 삽입하십시오.

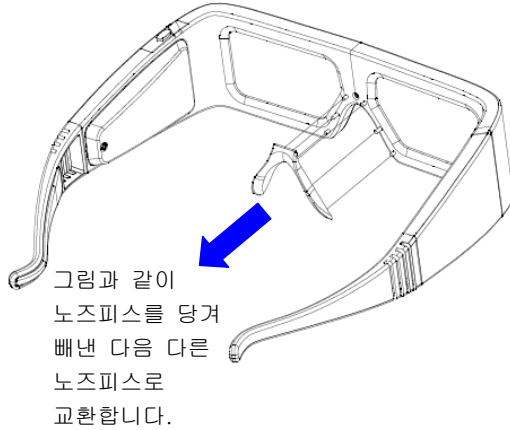

패키지 내의 품목

다음 부품이 패키지 내에 들어 있습니다.

- (1) 3D 안경



- (3) 교환할 수 있는 노즈피스
(대형, 중형, 소형)



- 사용자 설명서



적합성 준수 및 인증

3D 고글은 다음 규정을 준수합니다.

- FCC (Federal Communications Commission: 미연방통신위원회)
- CE (European Conformity: 유럽 공동체 인증)

중요한 안전 지침:

준수사항: 3D 안경 사용 시 규칙적으로 휴식을 취하고 언제라도 불편함을 느끼면 사용을 중단하십시오. 한 시간 사용한 다음 5 분씩 쉴 것을 권장합니다.

금지사항: 이 설명서에서 요약한 목적 외에 3D 안경을 사용하지 마십시오.

장시간 3D 안경을 사용하지 마십시오.

간질이나 감광성 간질의 병력을 가진 가족이 있는 경우 의사와 상담한 다음 3D 안경을 사용하십시오.

안경을 선글래스로 사용하지 마십시오.

부정적인 증상이 나타나면, 증상이 완전히 없어질 때까지 위험 가능성이 있는 활동(예: 자동차 운전)을 삼가십시오.

증상이 지속되면, 사용을 중단하고 의사와 증상에 대해 상담하기 전에는 3D 시청을 하지 마십시오.

드문 경우이긴 하지만 깜박거리는 패턴의 빛이 포함된 특정 유형의 TV 이미지나 비디오 게임을 보는 중 간질을 일으킬 수 있습니다.

다음과 같은 사람은 3D로 시청하기 전에 의사와 상담해야 합니다.

- 5 세 미만의 어린이.
- 본인 또는 가족이 간질 병력이 있는 사람.
- 깜박거리는 빛의 효과 때문에 간질이나 감각 장애를 일으킨 적이 있는 사람.

경고!

일부 빛의 패턴으로 인해 이전에 간질 병력이 없는 사람도 간질을 일으킬 수 있습니다. 3D 안경을 사용하기 전에 의사와 상담하십시오. 3D 이미지를 시청하는 동안 부정적인 증상을 느낄 경우 3D 사용을 중단하십시오.



P/N 36.Z0130G001-A